


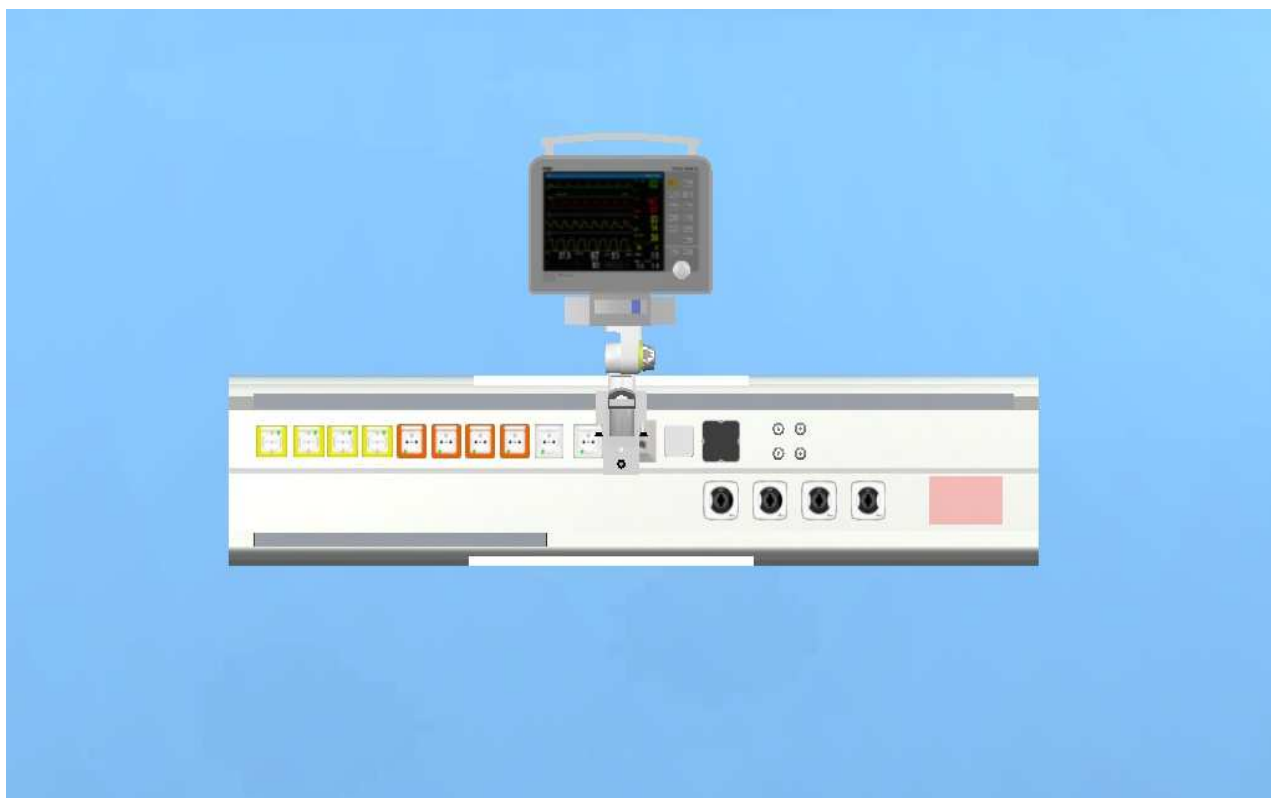


VYPRACOVAL	ZODPOV. PROJEKTANT	AUTORIZOVAL	TK PROJEKT LIBEREC ING. ZDENĚK KVAPIL Letná 431 Liberec 12, 460 01 tel. 485121632 tel. 602287810 e-mail: tk_projekt@volny.cz	
Bc. ŠTĚPÁN KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL	ING. ZDENĚK KVAPIL		
				
OBJEDNATEL: INVESTOR:	NEMOCNICE TŘINEC, p. o. Kaštanová 268, 739 61 Třinec		tel. 485121632 tel. 602287810 e-mail: tk_projekt@volny.cz	
MÍSTO STAVBY:	NEMOCNICE TŘINEC, p. o. – blok E			
NÁZEV AKCE:	ÚPRAVY 5.NP – PORODNÍ ODD.			
ČÁST:	ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ		DATUM:	05/2020
			FORMÁT:	4 A4
			STUPEŇ:	DPS
			ZAK. ČÍSLO:	3020.22
MĚŘÍTKO	Č. KOPIE	VÝKRES:	VÝKRES ČÍSLO	
NENÍ		LŮŽKOVÁ OSVĚTLOVACÍ RAMPA	MP-03	



Místnost.:		Jednolůžkové pokoje 409, 411 - délka 1650mm - 2x pravá - pro 1 lůžko Dvojlůžkový pokoj 414 - délka 3000mm - 1x levá - pro 2 lůžka Dvojlůžkové pokoje 417, 418, 423, 424 - délka 3300mm - 2x levá, 2x pravá - pro 2 lůžka					
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1500mm, 1650 mm		Linea N1		1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ode dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
1	x	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45		příprava pro slaboproud
4/1	x	x	x	4	1		1
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	x	x		1000mm		x	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Třinec - blok E, 5.NP porodní oddělení				Lůžková rampa			



Místnost.:		Novorozenecký pokoj - délka 1650mm - 1x pravá - pro 1 lůžko					
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1650 mm		Linea N2		1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ode dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
2	2	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45		příprava pro slaboproud
2/1	4/1	4/1	x	4	x		1
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	1	1		po celé délce		1	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Třinec - blok E, 5.NP novorozenecké				Lůžková rampa			



Místnost.:		Novorozenecké pokoje - délka 1650mm - 2x levá - pro 1 lůžko					
Délka rampy na lůžko		Typ		Přímé LED osvětlení		Nepřímé LED osvětlení	
1750 mm		Linea N2		1x na lůžko		1x na lůžko	
				vypínač na rampě		ode dveří	
Medicínální plyny - výbava na lůžko							
O2	AIR 4	N2O	VAC	CO2	AIR 8	AGSS	AirMotor
3	3	x	x	x	x	x	x
Silnoproudé a slaboproudé rozvody (počet zásuvek/počet obvodů) - výbava na lůžko							
MDO-bílá	ZIS-žlutá	VDO-oranž	DO-zelená	PA	2RJ45		příprava pro slaboproud
2/1	4/1	4/1	x	4	x		1
Příslušenství - výbava na lůžko							
Nosič 4 Infuzních lahví	Police 400x400	Držák monitoru vitálních fcí délky 200mm uchycený na medilištu		Medilišta horní pozice nosnost 50 kg na mb		Medilišta dolní pozice 600mm nosnost 50 kg na mb	
x	1	1		1000mm		x	
Projekt				Název zařízení			
Nemocnice Třinec - blok E, 5.NP novorozenecké				Lůžková rampa			