

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku

„Dodávka vjezdového platebního systému“

Pořadové číslo zakázky: P/026/INV/20

Číslo spisu na profilu zadavatele: P20V00000262

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 11. 10. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a sděluje následující:

Na základě prohlídky objektu a zaslané dokumentace prosíme o upřesnění dodávky dle Přílohy č. 1 - Zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

- požadavek č. 2) Aplikace, pomocí které bude možné označit vjezdový lístek jako lístek s volným výjezdem - licence pro minimálně 5 počítačů a uživatelů. Při prohlídce byl uveden jiný počet licencí, prosím upřesněte počet. Je aplikací myšleno řešení prostřednictvím mobilní aplikace?

Odpověď č. 1

Aplikací je myšleno softwarové řešení – např. tlustý nebo tenký (webový) klient parkovacího systému běžící na počítači s operačním systémem Microsoft Windows 7 a výše, pomocí kterého bude možné označit vjezdový lístek jako lístek s volným výjezdem. Součástí dodávky musí být taková licence, aby bylo možné provádět tuto činnost souběžně na minimálně 5 počítačích a minimálně 5 různými uživateli.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci

- požadavek č. 4) Celý systém bude dodán jako autonomní celek – tzn., že dodávka bude obsahovat veškeré komponenty nutné pro provoz systému vč. např. HW serveru, komponent kartového systému, vrátníků, kamer, kabeláže apod. Jaké kamery jsou tímto popisem požadovány, prosím uveďte minimální parametry a místa umístění?

Odpověď č. 2

Slovo „kamer“ je zde uvedeno chybně. V rámci nabídky nepožadujeme dodat žádné kamery.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci

- požadavek č. 5) Systém bude v maximální možné míře využívat stávající kabeláž.....Chápeme správně, že přílohy 7a a 7b ZD udávají stávající stav datové a napájecí kabeláže a že tato kabeláž je nyní plně funkční?

Odpověď č. 3

Kabeláž byla vybudována v rámci realizace stávajícího vjezdového systému v roce 2008, který je nyní v provozu, lze předpokládat, že kabeláž je plně funkční.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci

-požadavek č. 7) Minimálně 20ks dálkových ovladačů kompatibilních se stávajícími dálkovými ovladači jiných vjezdů do nemocnice. Upřesněte prosím frekvenci stávajících dálk.ovladačů, výrobce a počet jiných vjezdů do nemocnice

Odpověď č. 4

Frekvence stávajících dálkových ovladačů je 886 MHz, jsou používány ovladače zn. CAME. Těmito dálkovými ovladači budou ovládány dva vjezdy.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci

- požadavek č. 8) Možnost ovládat systém (pokladna, verifikace lístků apod.) přes počítač např. pomocí aplikace nebo webového rozhraní pro minimálně 5 uživatelů a počítačů. Při prohlídce byl uveden jiný počet uživatelů, prosím upřesněte počet.

Odpověď č. 5

Účelem požadavku je dohled a správa vjezdového systému příslušným oddělením nemocnice. Pro tento účel budou stačit licence pro 2 počítače, za předpokladu, že bude možné systém spravovat také přímo na serveru systému např. pomocí „připojení ke vzdálené ploše“.



Dotaz č. 6 k zadávací dokumentaci

- požadavek č. 16) sloupky závor budou obsahovat topení s termostatem. Je topení v závorech skutečně požadováno, pokud dodavatel garantuje bezporuchový chod závor i v mrazivém počasí?

Odpověď č. 6

Pokud dodavatel garantuje prokazatelně bezporuchový chod závor i v mrazivém počasí, topení není potřebné.

Ve Frýdku-Místku, dne 13. 10. 2020

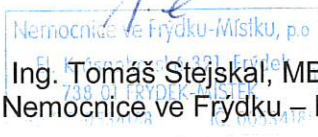

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.