

Zadavatel: **Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA – ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu, v souladu se ZZVZ
„**Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - Dodávka a instalace magnetické rezonance (MR 1,5T) včetně pozáručního servisu na dobu 8 let**“

Pořadové číslo zakázky: P/035/INV/18

Číslo spisu na profilu zadavatele: P1800000394

Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-038839

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 28. 11. 2018 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci

V zadávací dokumentaci, příloze č. 1 „Technická specifikace“, žádáte v odst. „1. Základní požadavky na magnet a gradientní systém“ mimo jiné následující:

- Gradientní systém s amplitudou gradientů minimálně 44 mT/m v osách x, y, z, a současně v jednom pulzu Slew Rate minimálně 200 T/m/s
- Minimální hodnoty Amplitudy a Slew Rate musí být dosažitelné současně a současně ve všech osách

Naše společnost disponuje přístrojem magnetické rezonance s gradientním systémem s amplitudou 45 mT/m a slew rate 200 T/m/s, přičemž obou hodnot nedosahuje v jeden časový okamžik, ale je jich schopen dosáhnout v rámci jednoho vyšetření i v rámci jedné sekvence. Dle technické normy ČSN EN 60601-2-33, která se zabývá zvláštními požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance, však v klinické praxi ani nelze v jeden časový okamžik tak vysokou amplitudu gradientu magnetického pole měnit s takovou rychlostí, aniž by docházelo ke stimulaci periferních nervů a tím k poškození pacienta.

Vzhledem k uvedenému proto dle našeho názoru neexistuje využitelný technický rozdíl a ani omezení v medicínském účelu poptávaného zařízení, které by vysvětlovalo požadavek na MR přístroj schopný dosáhnout požadovaných hodnot Amplitudy a Slew Rate současně v jednom časovém okamžiku a

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

současně ve všech osách. Toto naše tvrzení dokazuje I fakt, že námi nabízený přístroj ve všech ostatních požadovaných parametrech dosahuje nebo I vysoce překračuje požadavky zadavatele uvedené v Technické specifikaci.

Vzhledem k výše uvedenému předmětný požadavek, který nám neumožňuje zúčastnit se efektivně této veřejné zakázky s MR přístrojem shodné kategorie, považujeme za diskriminační vůči naší společnosti a účelově brání veřejné soutěži a chceme se proto dotázat:

Bude zadavatel akceptovat nabídku MR přístroje s gradientním systémem s amplitudou 45 mT/m a slew rate 200 T/m/s, kterých ale není schopen dosáhnout současně v jeden časový okamžik a současně ve všech osách a upraví v tomto směru své výše uvedené požadavky ze Zadávací dokumentace?


Odpověď č. 1

Ne, nebude akceptovat. Zadavatel trvá na zadávacích podmínkách - gradientní systém s amplitudou gradientů minimálně 44 mT/m v osách x, y, z, a současně v jednom pulzu Slew Rate minimálně 200 T/m/s

II.

S ohledem na skutečnost, že toto vysvětlení zadávací dokumentace nemůže rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení ve smyslu ust. § 99 odst. 2 ZZVZ, zadavatel nemění stanovenou lhůtu pro podání nabídek.

Ve Frýdku-Místku, dne 29. 11. 2018

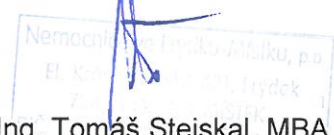

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.