

ZADAVATEL: **NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU, p.o.**
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
IČ: 00534 188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce malého rozsahu

Dodávka 2 ks stativů

Pořadové číslo zakázky: P/004/INV/19
Číslo spisu na profilu zadavatele: P19V00000021
VZ malého rozsahu

Zadavatel obdržel dne 5. 2. 2019 žádost o dodatečné vysvětlení zadávací dokumentace a sděluje následující:

Dotaz č. 1

Jakým způsobem budou stativy kotveny do stropu?

Odpověď č. 1

Stativy budou kotveny do železobetonového stropu chemickou kotvou.

Dotaz č. 2

Jsou všechna požadovaná média přivedena ke stativu?

Odpověď č. 2

Přívody energií pro stativ budou stavebně připraveny a ukončeny v místě instalace (uvedeno v kupní smlouvě čl.I, odst. 2 – viz příloha č.3 zadávací dokumentace).

Dotaz č. 3


Jaká je požadovaná specifikace příslušenství stativu: 2 - ramenné rameno (300 + 300 mm) na monitor životních funkcí, držák na 2 endoskopy (uchycení na eurolištu), držák na vaničky (uchycení na eurolištu). Především rozměry, nosnosti, typy apod.

Odpověď č. 3

2 – ramenné ramínko (MZ Liberec) – nosnost min 6 kg.



Držák na 2 endoskopy (uchycení na eurolištu): 2 endoskopy (např. BF 190)

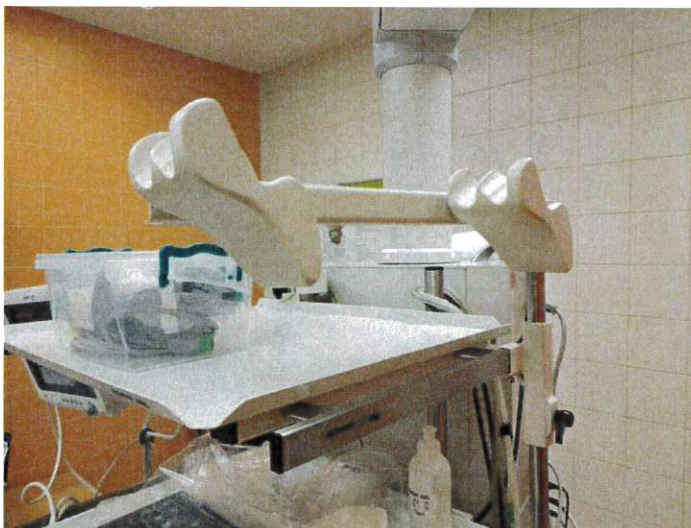

držák na vaničky (uchycení na eurolištu) rozměr cca 400 x 100 mm, nosnost cca 5kg




Dotaz č. 4

Jaká je specifikace kabeláže pro napájení monitorů a propojení s endoskopickou věží.
Především typy, hodnoty a počet.

Odpověď č. 4

Napájení monitorů 2x230V, signální 2x koax. kabel a 2x UTP.

Ve Frýdku – Místku, 5. 2. 2019

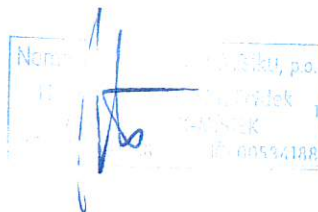

Stamp: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Ing. Tomáš Stejskal
TEL: 558 628 200
TEL: 558 628 200
TEL: 558 628 200

Ing. Tomáš Stejskal, MBA
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Y/n.